kab1-2

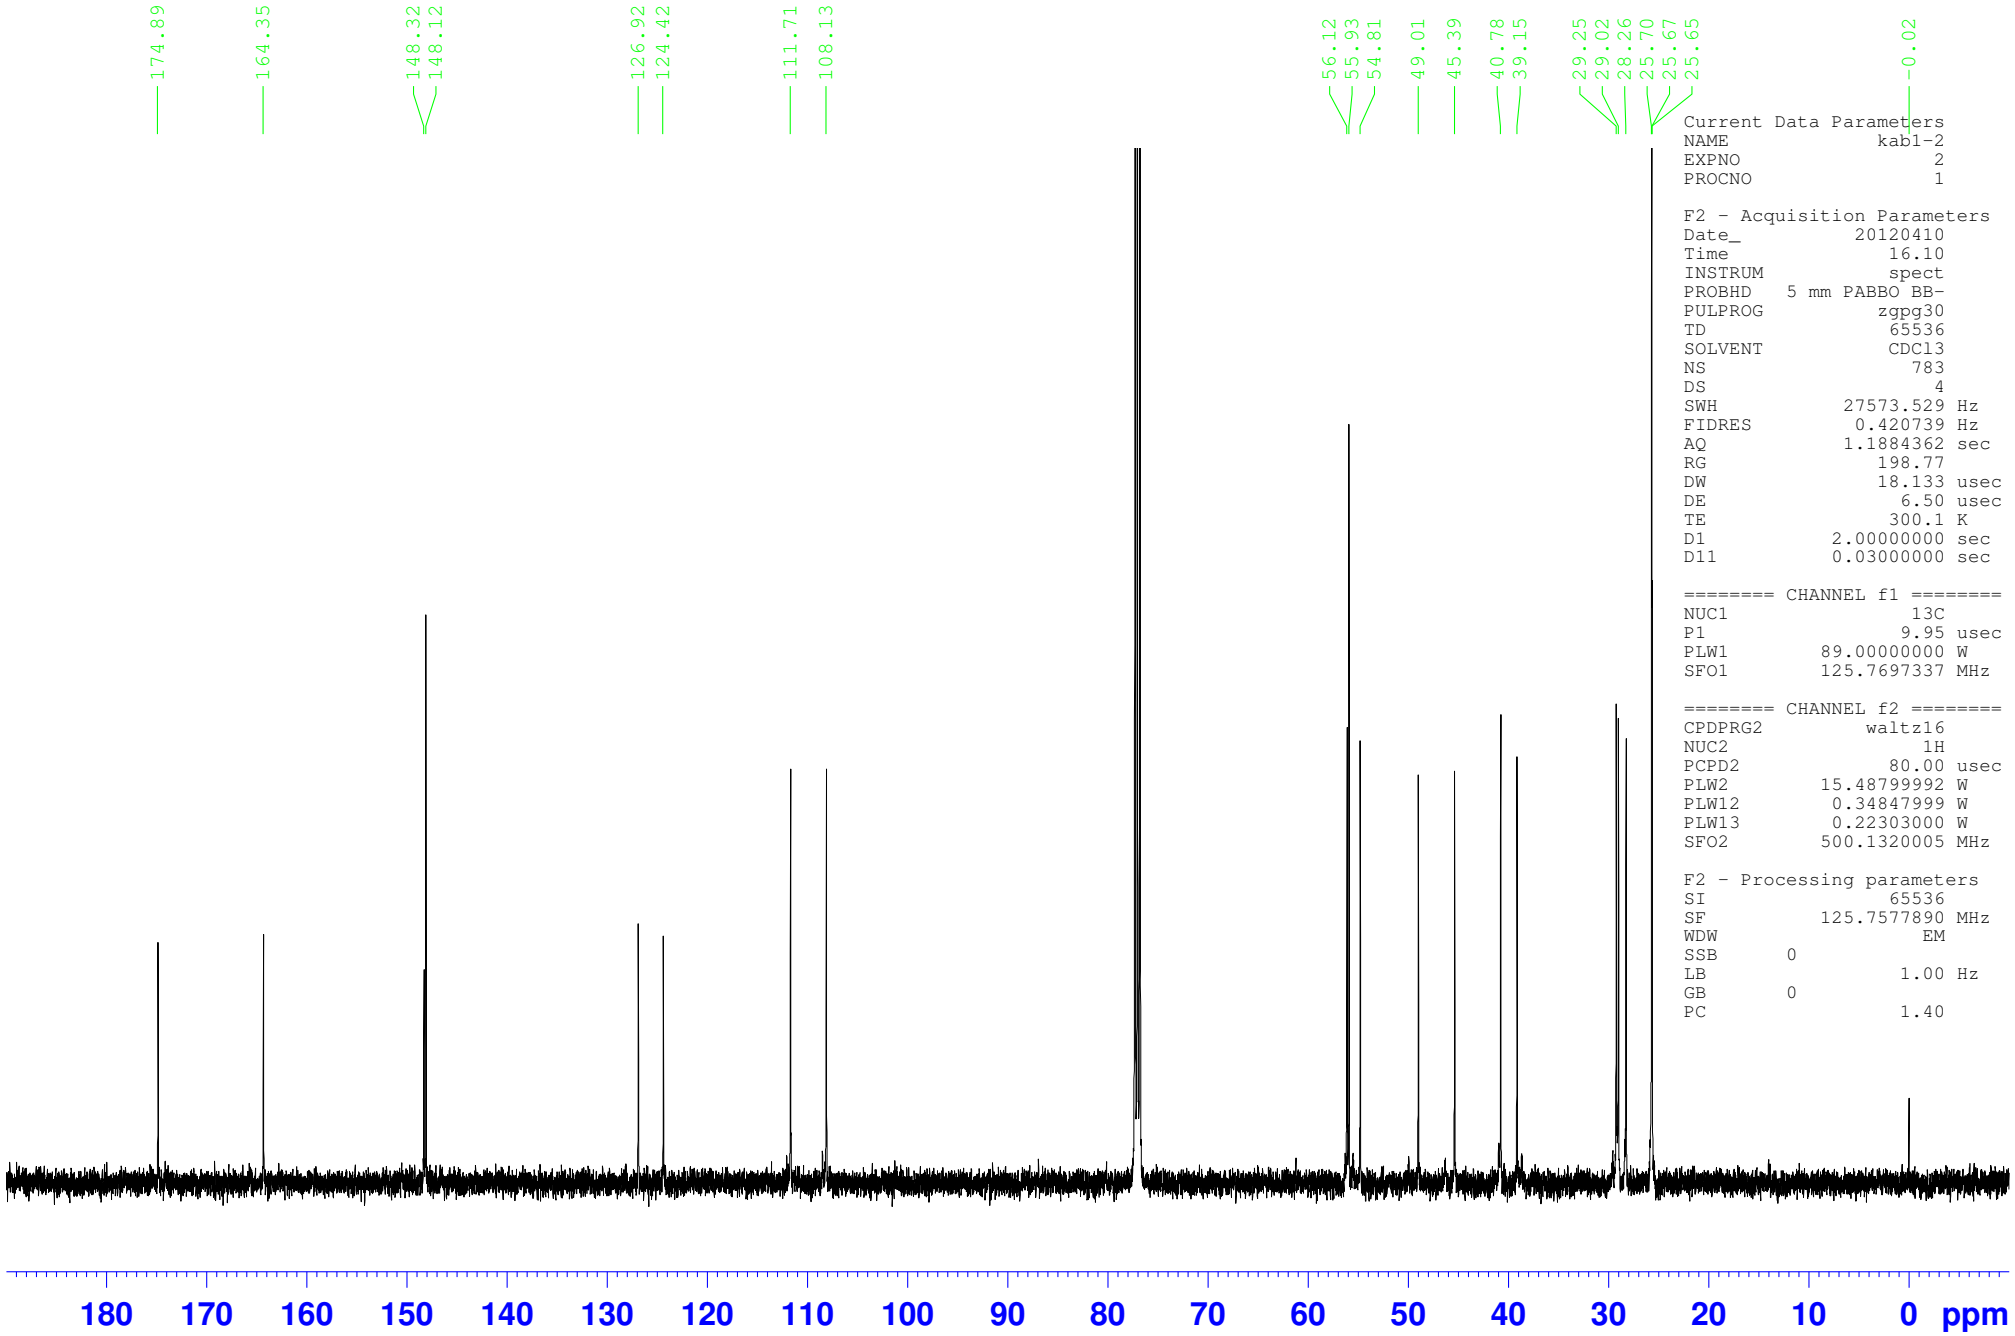
174.89
164.35
148.32
148.12
126.92
124.42
111.71
108.13
56.12
55.93
54.81
49.01
45.39
40.78
39.15
29.25
29.02
28.26
25.70
25.67
25.65
-0.02
Current Data Parameters
NAME kab1-2
EXPNO 2
PROCNO 1
F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20120410
Time 16.10
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm PABBO BB-
PULPROG zgpg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 783
DS 4
SWH 27573.529 Hz
FIDRES 0.420739 Hz
AQ 1.1884362 sec
RG 198.77
DW 18.133 usec
DE 6.50 usec
TE 300.1 K
D1 2.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
======== CHANNEL f1 ========
NUC1 13C
P1 9.95 usec
PLW1 89.00000000 W
SFO1 125.7697337 MHz
======== CHANNEL f2 ========
CPDPRG2 waltz16
NUC2 1H
PCPD2 80.00 usec
PLW2 15.48799992 W
PLW12 0.34847999 W
PLW13 0.22303000 W
SFO2 500.1320005 MHz
F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 125.7577890 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40
180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ppm